

ASR Schadeverzekering N.V.
Inkomen
Postbus 2072
3500 HB Utrecht

Functiebeoordeling vinger en duim

Algemeen

Naam	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Dossiernummer:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Datum onderzoek	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Uitleg

Bij dysesthesie, vervormde gewrichten, amputaties, littekens en afwijkende stand van de vingers en de duim de betreffende afwijkingen graag zo exact mogelijk beschrijven.

Vingers en handen

Wilt u de hieronder genoemde functies in graden aangeven voor zowel de betreffende vingers als de overeenkomende vingers van de andere hand?

	DIP		PIP		MCP				
Extensie (norm)	30°		0°		30° - 45°				
Flexie (norm)	70°		100°		90°				
Vinger	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links			
2. extensie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
flexie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
3. extensie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
flexie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
4. extensie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
flexie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
5. extensie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
flexie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Links				Rechts					
Kunt u, indien van toepassing, het amputatieniveau aangeven? Kunt, indien van toepassing, de locatie van de gevoelsstoornissen aangeven?					Kunt u, indien van toepassing, het amputatieniveau aangeven? Kunt, indien van toepassing, de locatie van de gevoelsstoornissen aangeven?				

Graag de bewegingsuitslagen aangeven in graden

Duimfunctie links

	Flexie (gr)	Normaal	Extensie (gr)	Normaal
IP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	80°	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10°
MCP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	60°	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0°-40°
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	Adductie *	Normaal		
CMC	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0 cm	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	Radiaal abductie (gr)	Normaal		
CMC	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	50°	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	Oppositie **	Normaal		
CMC	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0 cm	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

* in cm van IP gewricht duim tot MP gewricht pink

** in cm van IP gewricht duim tot MP gewricht middelvinger

Duimfunctie rechts


	Flexie (gr)	Normaal	Extensie (gr)	normaal
IP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	80°	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10°
MCP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	60°	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0°-40°
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	Adductie *	Normaal		
CMC	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0 cm	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	Radiaal abductie (gr)	Normaal		
CMC	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	50°	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	Oppositie **	Normaal		
CMC	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0 cm	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Sensibiliteitsstoornis van de hand

Betref: rechts / links


Linkerhand

Rechterhand

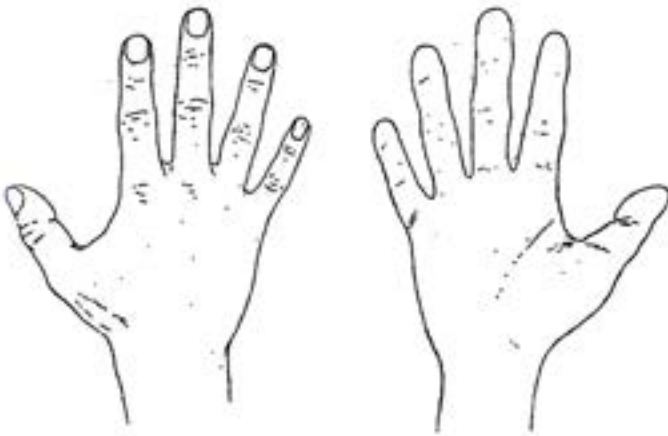


Dorsaal


Palmar

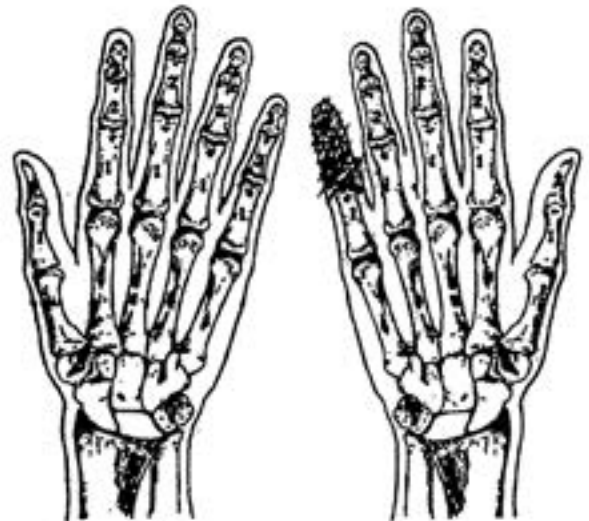

Wij verzoeken de arts , in geval van verlies (d.w.z. amputatie, afsnijding, enz.) van leden van vingers of delen daarvan, op bovenstaande schema's zo nauwkeurig mogelijk te willen aangeven, welk deel verloren is gegaan.

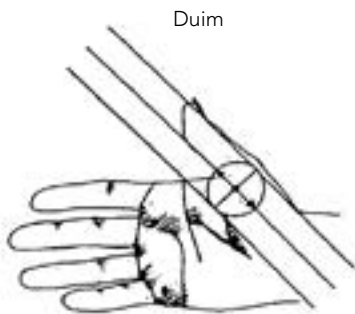

Duim

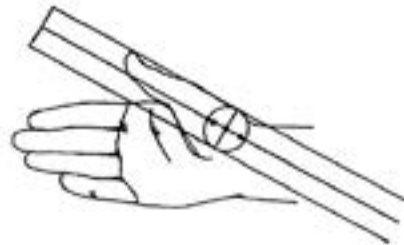


15°




30°

1^ometacarpaal gewricht duim
normale functie: flexie 0° - 15°
extensie 0° - 30°

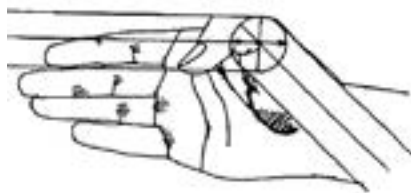

Metacarpophalangeaal
gewricht van de duim
normale functie 0° - 60°

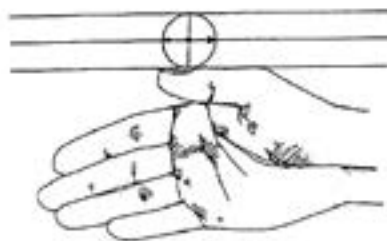

Metacarpophalangeaal
gewricht van de duim
normale functie 0° - 80°

